Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

# DEIONIZZATORI “M.F.”


# CONDUCIMETRO A SCALA

## ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONDUCIMETRO A SCALA

**Gli apparecchi della nuova serie 2008 sono corredati di conducimetro a scala a norme di sicurezza.**

### SCALA CON DOPPIA LETTURA MEGAOHM/MICROSIEMENS

Questa scala va usata per il ciclo normale(prima frazione)che produce un effluente con valori massimi di resistenza specifici. Per gli usi più fini di laboratorio(analisi, ricerca, ecc.)l’effluente può essere utilizzato fino a valori di 1 Mega ohm. Dopo questi valori inizia la seconda frazione che può essere utilizzata per usi blandi( batterie, lavaggio, ecc).

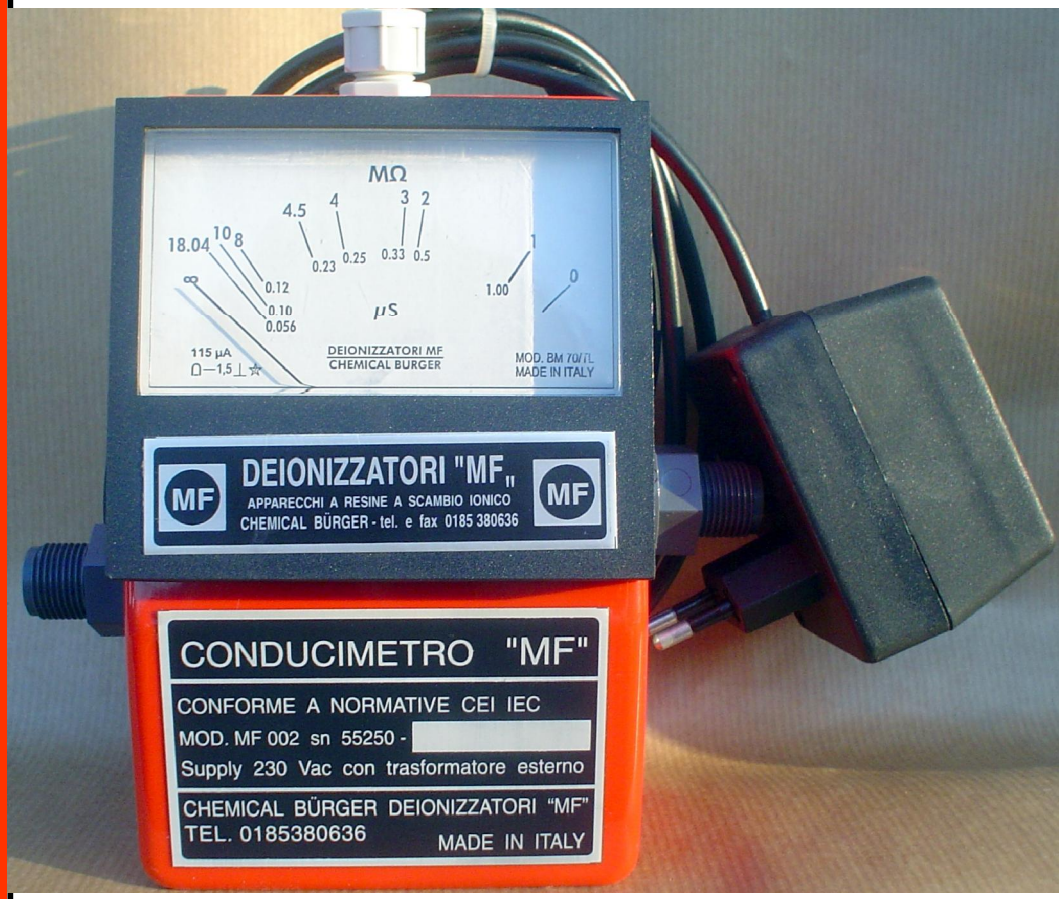


### CONTROLLO CONDUCIMETRO

I controlli possono essere effettuati versando nel raccordo di sinistra del conducimetro acqua comune e distillata o bidistillata.

1.Con acqua comune l’ago deve segnare zero.

2.Con acqua distillata o bidistillata l’ago deve segnare 18 MΩ. In posizione di riposo l'ago deve restare a fondo scala (∞) e nella stessa posizione staccando la spina della presa di corrente.

3.In caso di risposta negativa ai controlli 1 e 2 o di guasto di altro genere, non aprire lo strumento ma spedirlo alla nostra sede per le necessarie riparazioni.

**N.B.** La tensione normale del conducimetro è di 12 V.
***L’acqua deionizzata non può essere bevuta***

**Disponibili, secondo le esigenze del cliente, conducimetri in MicroSiemens.**

MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO 1 Bar

**Prodotto e distribuito da:**
**DEIONIZZATORI “M.F.”** Chemical Bürger S.n.c.
APPARECCHI A RESINE A SCAMBIO IONICO PRODOTTI CHIMICI - DISINFEZIONI
16030 SAN SALVATORE DI COGORNO GE
V. Adriano V° 27/31-Tel. 0185/380636

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

| MEGAOHM | MICROSIEMENS |
|---|---|
| 0,1 | 10 |
| 0,2 | 5 |
| 0,3 | 3,33 |
| 0,5 | 2,00 |
| 0,7 | 1,43 |
| 1 | 1,00 |
| 2 | 0,50 |
| 3 | 0,33 |
| 4 | 0,25 |
| 5 | 0,20 |
| 6 | 0,16 |
| 7 | 0,14 |
| 8 | 0,12 |
| 9 | 0,11 |
| 10 | 0,10 |
| 12 | 0,08 |
| 14 | 0,07 |
| 16 | 0,06 |
| 18 | 0,05 |

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

SAE ELECTRONIC CONVERSION srl

Via Lungo Torrente Secca 12r – 16163 – BOLZANETO (GE)
Tel. 010 7261834 – Fax 010 7261836
E-mail: sae@sae-elettronica.it - http: www.sae-elettronica.it

# NORME DI RIFERIMENTO
## *REFERENCE NORMS*

del 11-02-08 Comm. 6566

Cliente *Customer* CHEMICAL BURGER Snc

Destinazione *Destination* IDEM

Tipo di Apparecchiatura *Type of Equipment* CONDUTTIVIMETRO Supply 230Vac – CON TRAFO DOPPIO ESTERNO DI ISOLAMENTO

Ordine N° *Order N°* Fax del 19/10/2007

Numero di Disegno e Matricola *Drawing and Serial Number* N° 39941 S.N. 55250-1+30

Circuitazione *Electrical fitting* Primario – Secondario

Conforme a Normative *Corresponding to* [X] CEI [X] IEC

**Dichiariamo che il materiale sopra indicato è stato costruito in Italia secondo le normative CE.**

***We declare that the above material was built in Italy in according with CE norms.***

**Responsabile Produzione SAE :** Maurizio Pedemonte
*Production Responsable :*

**Responsabile Qualita' Reparto Collaudi :** Minfo Paolo
*Quality Control Responsable:*

**IL RESPONSABILE**
Maurizio Pedemonte

**Mod. Mq 0707-13**